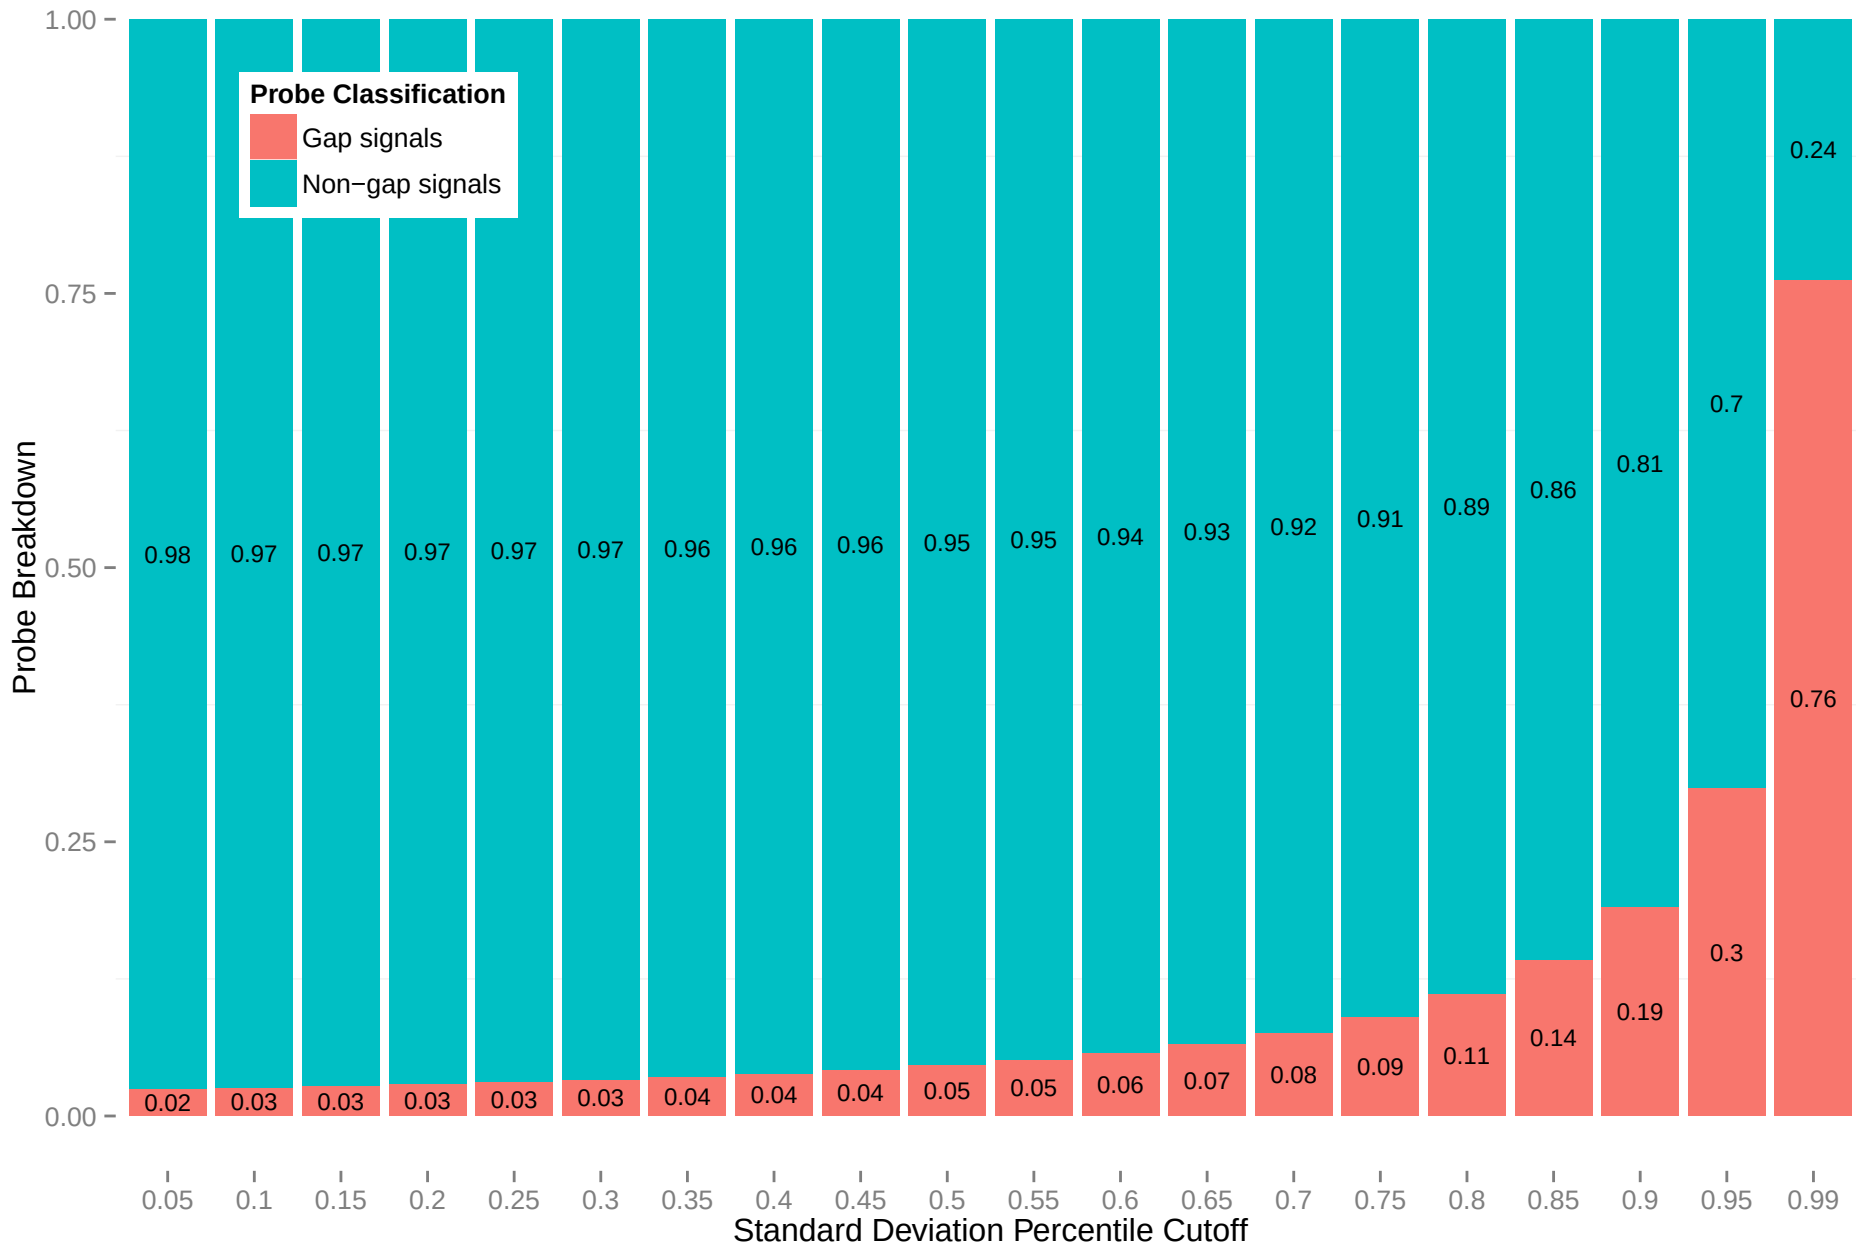
Probe Classification
Gap signals
Non−gap signals
Probe Breakdown
1.00
0.75
0.50
0.25
0.00
0.98
0.97
0.97
0.97
0.97
0.97
0.96
0.96
0.96
0.95
0.95
0.94
0.93
0.92
0.91
0.89
0.86
0.81
0.7
0.24
0.02
0.03
0.03
0.03
0.03
0.03
0.04
0.04
0.04
0.05
0.05
0.06
0.07
0.08
0.09
0.11
0.14
0.19
0.3
0.76
0.05
0.1
0.15
0.2
0.25
0.3
0.35
0.4
0.45
0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
0.99
Standard Deviation Percentile Cutoff